




El siguiente Boletín es elaborado con la información del primer trimestre de 2021 con la finalidad de retroalimentar y fortalecer la seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos.

1. FARMACOVIGILANCIA


Ciencia que se encarga de la detección, análisis y gestión de cualquier problema relacionado con **MEDICAMENTOS** con el fin de prestar una atención segura a los pacientes.

En la **Grafica 1**. Se puede observar que las reacciones adversas medicamentosas más comunes reportadas en la ese pasto salud durante el 1 trimestre del 2021 son el rash Cutáneo y cefalea intensa.

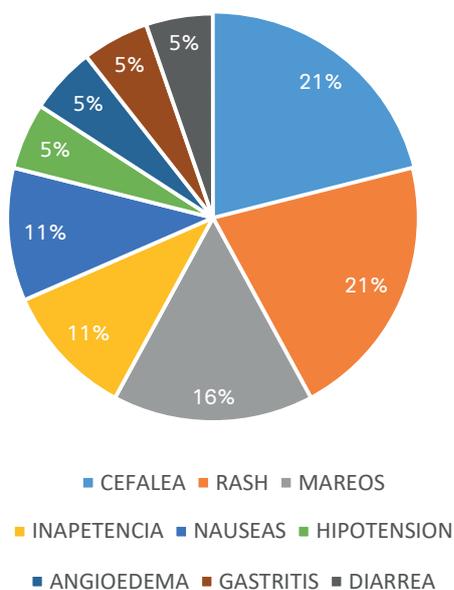

Grafica 1. Reacciones Adversas Medicamentosas reportadas por el personal de salud.

En la **Grafica 2**. Se puede observar los medicamentos más reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas, siendo el alimento en polvo a base de maltodextrina, nitrofurantoina y losartan los medicamentos más reportados con reacciones adversas.

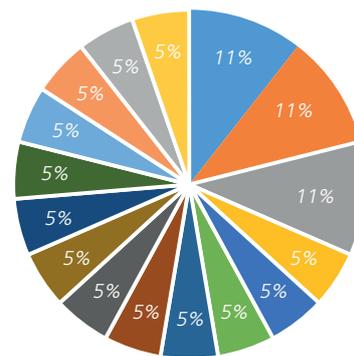


- MICRONUTRIENTES
- LOSARTAN
- HIOSCINA MAS DIPIRONA
- LIDOCAINA
- FLUCONAZOL
- DOXICICLINA
- SULFASALAZINA
- NITROFURANTOINA
- OMEPRAZOL
- MEDROXIPIROGESTERONA
- CLARITROMICINA
- ERGOTAMINA
- DICLOXACILINA
- CARBONATO DE CALCIO

Grafica 2. Medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas

En la **Grafica 3**. Se observa los errores más relevantes de formula médica. El error más común es el error en la cantidad de medicamento formulado, seguido por el error en la forma farmacéutica y por el error en el medicamento prescrito.

Errores de Formula Medica

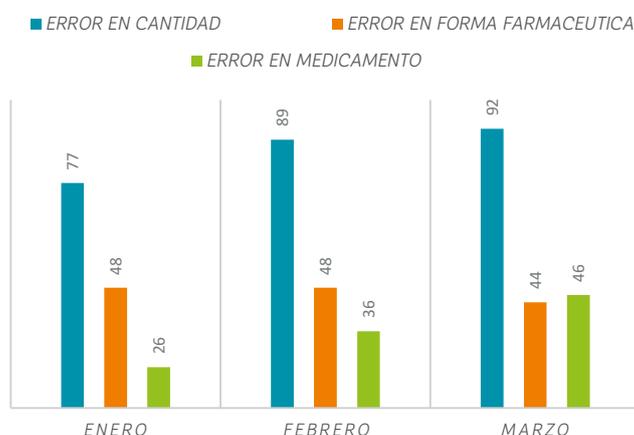

Grafica 3. Errores de formula médica.

Nota: Los medicamentos que se han reportado con más errores en la formulación son:

Albendazol tabletas y Albendazol suspensión

Cromoglicato nasal y Cromoglicato oftálmico

Tiamina solución inyectable y Tiamina tabletas

Beclometasona Nasal y Beclometasona Bucal

Salbutamol Jarabe y Salbutamol inhalador

En la Grafica 4. Se muestran la cantidad de errores de dispensación, se recuerda a todo el personal del servicio farmacéutico revisar siempre que sea el paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, forma farmacéutica correcta, vía correcta y cantidad correcta.


Nota: Los errores de dispensación presentados son:

Dispensación de nimodipino a cambio de nifedipino

Dispensación de prazosina a cambio de trazodona

Dispensación de ácido valproico a cambio de verapamilo

Error de Dispensación

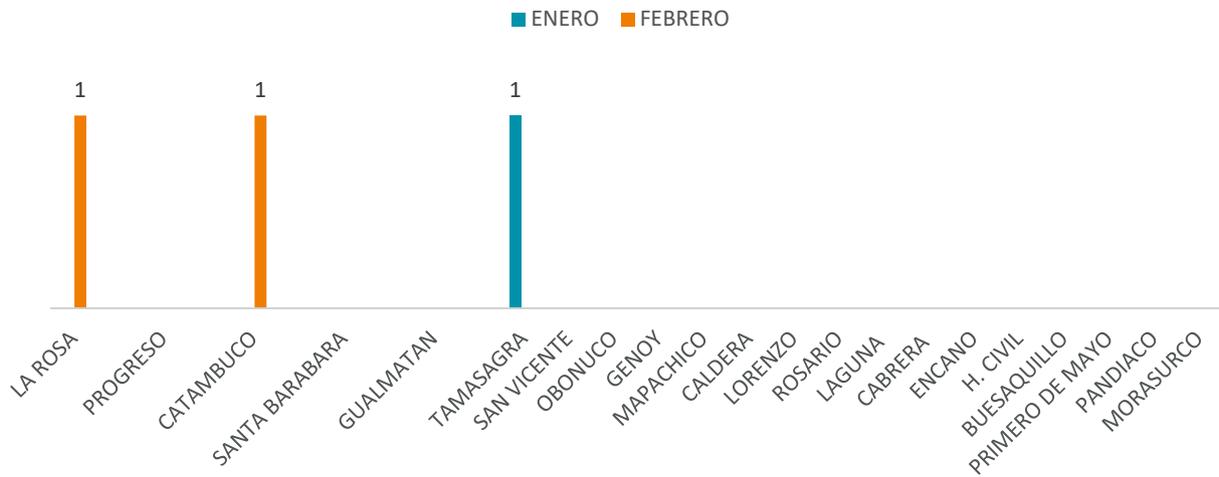


TECNOVIGILANCIA

Es un Sistema de vigilancia de **DISPOSITIVOS MÉDICOS** que identifica, evalúa, gestiona y divulga los eventos o incidentes adversos que presentan los dispositivos médicos, para mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes.

En la Grafica 5. Se evidencian los reportes realizados en los centros de salud por fallas de calidad durante el uso de los dispositivos médicos. Estos reportes sirven para gestionar con el fabricante y tener presente para futuras compras.

Fallas de Calidad Dispositivos Medicos

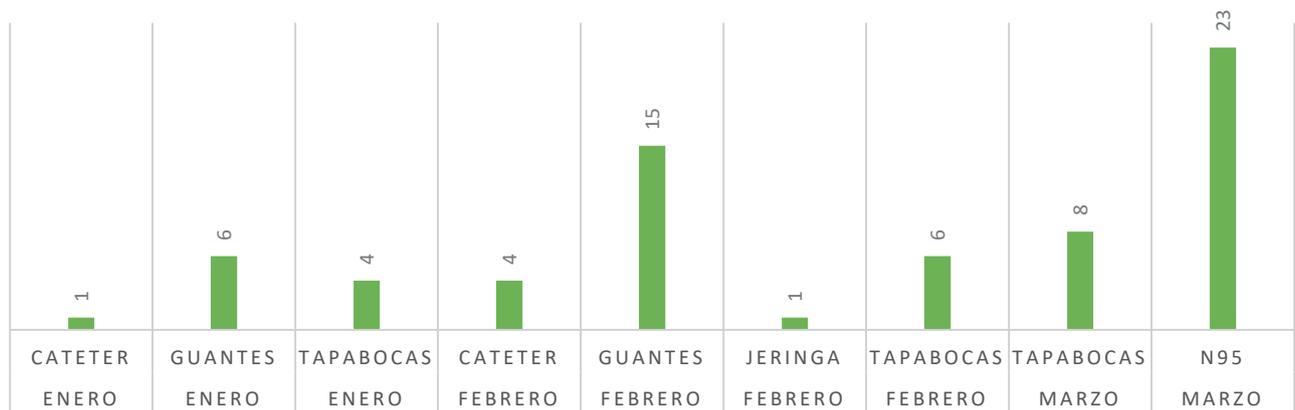

Grafica 5 Reportes de falla de calidad de Dispositivos médicos.

RECONOCIMIENTOS

Agradecemos el compromiso de todos con la seguridad del paciente específicamente en el apoyo a los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia destacando el trabajo realizado por las siguientes 4 centros de salud quienes fueron los que más reportaron casos relacionados con medicamentos y dispositivos médicos durante el cuarto trimestre de 2020.

- Centro de Salud Genoy
- Centro de Salud San Vicente
- Centro de Salud Lorenzo
- Centro Hospital La Rosa