




El siguiente Boletín es elaborado con la información del segundo trimestre de 2023 con la finalidad de retroalimentar y fortalecer la seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos.

## FARMACOVIGILANCIA

Ciencia que se encarga de la detección, análisis y gestión de cualquier problema relacionado con MEDICAMENTOS con el fin de prestar una atención segura a los pacientes.


En la Grafica 1. Se puede observar que la reacción adversa medicamentosa más común reportada durante el 2 trimestre del 2023 es el rash cutáneo.

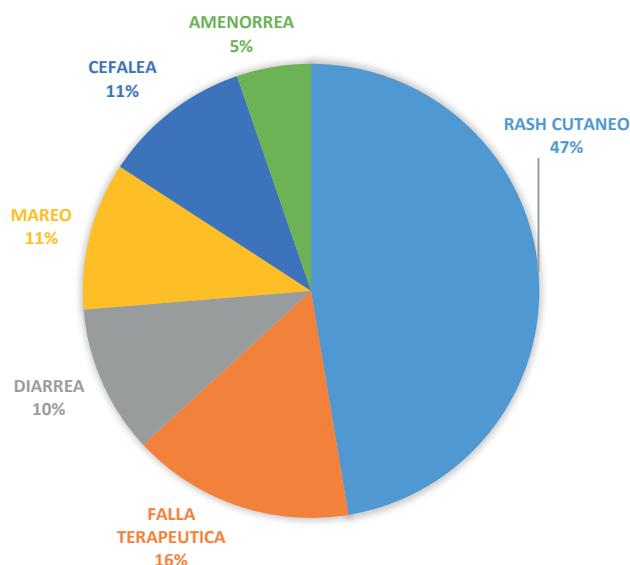

Grafica 1.

Reacciones Adversas Medicamentosas reportadas

Grafica 2. Se puede observar los medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas.

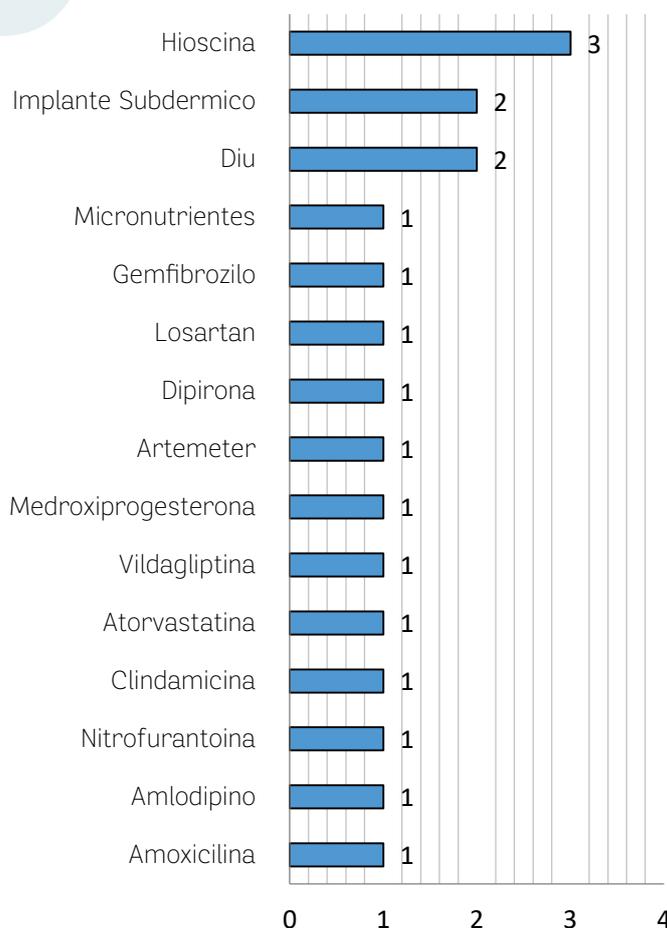


Grafica 2.

Medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas

Grafica 3. Se puede observar los errores de formula medica por sede.

Grafica 3. Número de errores de formula medica.

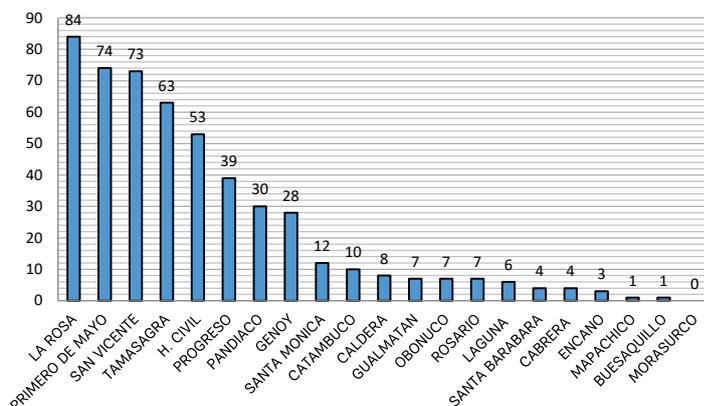

**OJO:** Dentro de estos errores de fórmula médica se evidenció un error que alcanzó al paciente en el cual se formuló levotiroxina de 25 mcg en lugar de levonorgestrel etinilestradiol, un día después se evidencia el error y se administra el medicamento correcto.


### LECCIONES APRENDIDAS:

- Realizar doble chequeo entre el médico y el paciente al momento de formular el medicamento.
- Máxima concentración al momento de formular.
- Al momento de dispensar revisar que el diagnóstico coincida con el medicamento formulado.
- Realizar doble chequeo entre el personal del servicio farmacéutico y el paciente al momento de dispensar el medicamento.

## TECNOVIGILANCIA

Es un Sistema de vigilancia de **DISPOSITIVOS MÉDICOS** que identifica, evalúa, gestiona y divulga los eventos o incidentes adversos que presentan los dispositivos médicos, para mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes.

**Grafica 4.** Se evidencian los reportes realizados por fallas de los equipos biomédicos. Estos reportes sirven para analizar los posibles causantes de las fallas repetitivas, fortalecer el mantenimiento y uso seguro de los equipos.

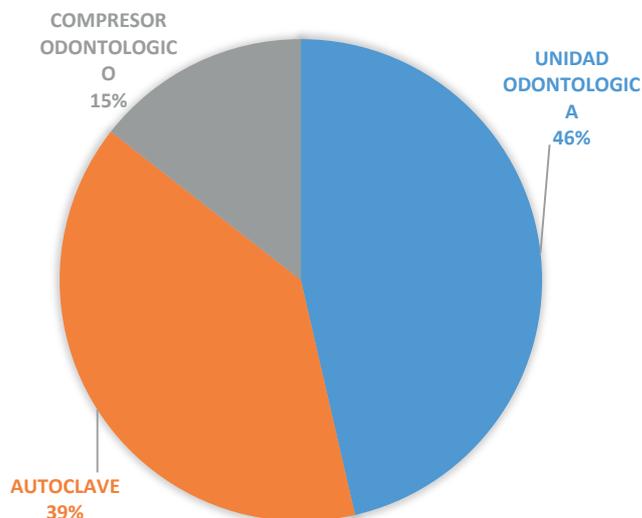

**Grafica 4.** Reportes de fallas en equipos biomédicos.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

Acuérdate de apagar el bombillo de la unidad odontología una vez la termines de usar, esto ayuda a prolongar la vida útil del mismo.

Verifica la válvula de purga del compresor odontológico, asegúrate de su cierre correcto antes de su uso

## RECONOCIMIENTOS

Agradecemos el compromiso de todos con la seguridad del paciente específicamente en el apoyo a los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia destacando el trabajo realizado por las siguientes 4 centros de salud quienes fueron los que más reportaron casos relacionados con medicamentos y dispositivos médicos durante el segundo trimestre de 2023.

- Centro de Salud **Primero de Mayo**
- Centro de Salud **Tamasagra**
- Centro de Salud **San Vicente**
- Centro de Salud **Hospital La Rosa**