



El siguiente Boletín es elaborado con la información del cuarto trimestre de 2025 con la finalidad de retroalimentar y fortalecer la seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos.

FARMACOVIGILANCIA

EFFECTO COLATERAL DE MEDICAMENTO: Cualquier efecto involuntario de un producto farmacéutico que ocurre a las dosis normalmente utilizadas en el hombre, que está relacionado con las propiedades farmacológicas del fármaco.


CÁPSULA DE FARMACOVIGILANCIA

Evento Adverso Leve - Error de Prescripción.

En el mes de octubre se le prescribió a una paciente Loperamida sin justificación clínica, causándole un evento adverso leve.

¿Que aprendimos?

- » Verificar las condiciones clínicas del paciente.
- » Fortalecer la comunicación entre médico y farmacia ante dudas sobre la prescripción.
- » Educar al paciente sobre efectos adversos y cuándo suspender el medicamento.



Gráfica 1. Reacciones Adversas Medicamentosas reportadas.


En la Gráfica 1. Se puede observar que la reacción adversa medicamentosa más común reportada durante el cuarto trimestre de 2025.

Eventos Adversos Leves - Errores de administración

En el cuarto trimestre se presentaron errores de administración de medicamentos, ocasionándoles a los pacientes eventos adversos leves.


Que aprendimos?

- » Fortalecer la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.
- » Fortalecer el cumplimiento de guías institucionales.
- » Prevenir de la sobrecarga laboral
- » Fortalecer la capacitación al personal asistencial.



Gráfica 2. Medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas.

En la Gráfica 2. Se puede observar los medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas, en los cuales los más comunes fueron.

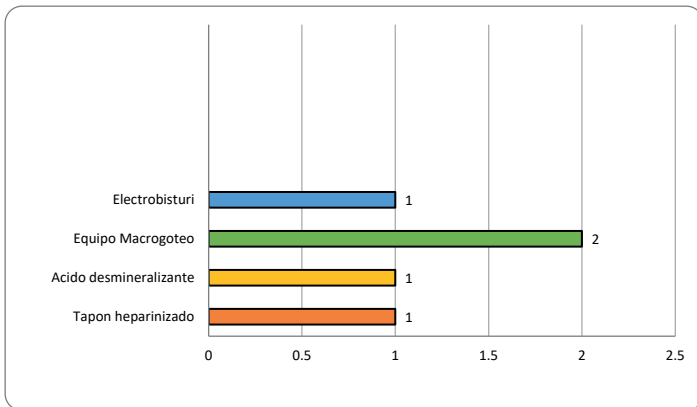

Gráfica 3. Reportes de calidad en dispositivos médicos.

En la Gráfica 3. Se evidencian los reportes realizados en los centros de salud por fallas de calidad durante el uso de los dispositivos médicos.

TECNOVIGILANCIA

EQUIPO BIOMEDICO: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos e hidráulicos y/o híbridos, que para su uso requieren una fuente de energía; incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento.

Evento Adverso Leve - Quemadura con Electrocauterio

En el mes de diciembre en el servicio de quirófano por desconocimiento del manejo de equipo y correcto uso de placas de electrocauterio se colocó placa en brazo de paciente provocando quemadura.

Que aprendimos?

» Todo el personal debe recibir inducción específica al momento de ingreso a la institución los equipos biomédicos deben contar con guía rápida para su uso en todos los ambientes.

» El sitio de postura de placa de electrocauterio debe ser en la zona más cercana a el sitio de incisión del paciente y así mismo donde exista mayor masa muscular.

» Mejorar la comunicación entre el equipo de salud

REACTIVO VIGILANCIA

ALERTA SANITARIA: Toda sospecha de una situación de riesgo potencial para la salud de la población y/o de trascendencia social, frente a la cual sea necesario el desarrollo de acciones de Salud Pública urgentes y eficaces.

REPORTE DE EFECTOS INDESEADOS


El reporte de efectos indeseados de los reactivos de diagnóstico in vitro es un mecanismo que tiene como fin principal suministrar al INVIMA, información clara, veraz y confiable relacionada con situaciones identificadas por los diferentes actores del programa y que inciden o pueden incidir en la calidad, seguridad y desempeño de los reactivos de diagnóstico in vitro antes o durante su uso por parte de los servicios que manipulen reactivos de diagnóstico in vitro.

La gestión de los efectos indeseados se debe realizar mediante seguimiento de su ocurrencia, estableciendo planes de mejora que permitan evaluar las acciones preventivas y correctivas.



Gráfica 4. Efectos indeseados con el uso de reactivos de diagnóstico in vitro.

En la Gráfica 4. Durante el IV trimestre del 2025 no se presentó ningún efecto indeseado con el uso de reactivos de diagnóstico in vitro en los laboratorios clínicos de la empresa.

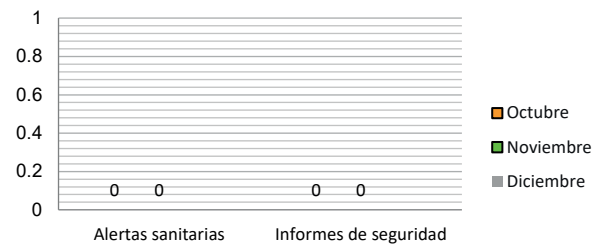

Gráfica 5. Alertas Sanitarias o informes de seguridad

En la Gráfica 5. Se observa que durante el IV trimestre del 2025 no se identificó en página del Invima reporte de alertas sanitarias o informes de seguridad relacionadas con reactivos de diagnóstico o dispositivos médicos que manejaran en los laboratorios clínicos de la empresa.

RECONOCIMIENTOS

Agradecemos el compromiso de todos con la seguridad del paciente específicamente en el apoyo a los programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia destacando el trabajo realizado por los siguientes 4 centros de salud quienes fueron los que más reportaron casos relacionados con medicamentos y dispositivos médicos durante el cuarto trimestre de 2025.

CS San Vicente, CS Primero de Mayo, CS Progreso y Hospital Local Civil

Elaborado por: Q.F Juliana Andrea Bolaños // Ing. Mario Naranjo